

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las **10:00 (diez)** horas del día **16 de abril del año 2025**, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la **Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja**, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, Colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----

La junta fue validada por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretaria del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instaló formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido a las **10:00 horas del día 14 de abril de 2025**, conforme a lo indicado en la convocatoria. -----

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y <http://conferencias.uaa.mx/>-----

El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Depto. de Proyectos Institucionales de la DGPyD), quienes solventarían las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----

La convocante realiza las siguientes **aclaraciones** a la convocatoria.-----

No.	Aclaración
1.	La Convocante realiza la siguiente aclaración dentro del numeral IX, específicamente en la tabla que indica la muestra física a presentar, el cual deberá considerarse de la siguiente manera:

Desglose de conjunto de partidas y entrega de muestra física por conjunto de partida e individual		
Partidas	Conjunto de Partidas*	Muestra física
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35	1	Se deberá presentar muestra física consistente en: <ul style="list-style-type: none"> Se deberá presentar muestra física con Certificado de la Norma ASTM A240 consistente en: una placa o recorte de 30 cm de ancho por 30 cm de largo de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta del acero inoxidable ANSI T-304 de CALIBRE 18 El licitante deberá presentar el certificado ASTM A240 del lote del acero que se ocupará para fabricar el mobiliario de la presente licitación en las partidas que se elaboran con acero inoxidable ANSI T-304, dentro de su propuesta. Se deberá presentar muestra física consistente en: un recorte preferentemente de 30 cm de ancho por 30 cm de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta de melamina de 28mm de espesor en color blanco.
15, 23, 26, 33 y 34	2	Sin muestra física
2, 18, 4, 20 y 30	3	Muestra física de la partida 2.
Descripción	Partidas	Muestra física


[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

28	Individual	Muestra física de la partida 28.
Descripción	Partidas	Muestra física
11	Individual	Sin muestra física
12	Individual	Sin muestra física
13	Individual	Sin muestra física
14	Individual	Sin muestra física
16	Individual	Sin muestra física
24	Individual	Sin muestra física
25	Individual	Sin muestra física

No.	Aclaración
2	<p>La convocante realiza la siguiente aclaración respecto al numeral X. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, subnumeral 2.2, de las bases de la convocatoria, conforme a lo siguiente:</p> <p>Para dar cumplimiento al requisito anteriormente señalado, se deberá presentar RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal o apoderado de la empresa que participe en el procedimiento de licitación (En caso de personas morales).</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento).</p>
3	<p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada.</p>
4	<p>La Convocante realiza la siguiente aclaración para la descripción de la Partida 2 y Partida 18:</p> <p>Debe decir: <i>BANCO ALTO FIJO PARA LABORATORIO COLOR NEGRO, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Banco alto fijo de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies de altura ajustable y regatones de poliamida, giro de 360°.</i></p> <p><i>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 años por defectos de fabricación y materiales.</i></p> <p>Imagen de referencia:</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

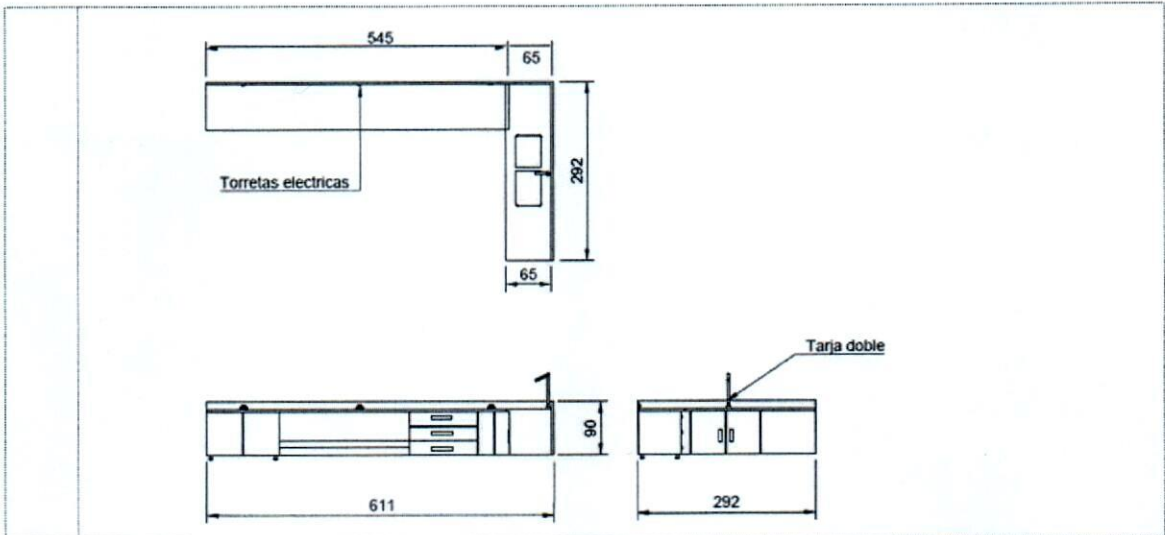

6 La Convocante realiza la siguiente aclaración en las medidas para la partida 14:

Debe decir:

GABINETE DE SEGURIDAD IMPORTADO PARA RESGUARDO DE SUSTANCIAS CORROSIVAS DE 1.65 mts x 1.09 mts x 0.46 mts (alto, fte, ancho), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.

Gabinete de seguridad importado para sustancias corrosivas con capacidad para 45 galones. Medidas de 1.65 mts x 1.09 mts x 0.46 **mts** (alto, fte, ancho), con 2 puertas, color azul, Su fabricación cumple con las especificaciones de seguridad marcadas por EPA, NPFA, OSHA. El gabinete está fabricado de lámina galvanizada con recubrimiento epóxica. La construcción de los paneles laterales, traseros y de las puertas está basada en una doble fondo y capa de protección de acero para contener derrames o riesgos en su interior. Las puertas cuentan con un sistema de candado cilíndrico y juego de llaves y con opción para un candado de seguridad adicional. Los gabinetes vienen preparados con puertos de conexión para un sistema de extracción y uno de ventilación en sus costados. Así mismo están preparados para su operación en serie con gabinetes del mismo tipo. Incluyen bandejas de polietileno en cada estante de acero galvanizado de altura variable y un forro de polietileno por separado para el sumidero inferior y resistir productos químicos agresivos.

Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas practicas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.
GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y
GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo

7 La Convocante realiza la siguiente aclaración para la partida 23:

Debe decir:

RACK PARA ALMACENAJE DE MICROSCOPIOS DE 0.90 mts X 0.45 mts X **2.50** mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.

Racks estructurales de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts X 0.45 mts X **2.50** mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, recubiertos de pintura epóxica electrostática con 4 entrepaños de **lámina galvanizada calibre 18, con refuerzos omega de calibre 16**, con un espacio libre para acomodar microscopios de 0.60 mts. por espacio.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

	<p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>
8	<p>La Convocante realiza la siguiente aclaración para la partida 27:</p> <p>Debe decir: MESA ISLA ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 5.10 mts x 0.65 mts x 0.90 mts, (La,An,Al) COLOR GRIS OSCURO MC EN LA ESTRUCTURA, MODULADA EN 3 PARTES DE 1.70 mts C/U CON TORRETA ELECTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 mm COLOR BLANCO ABSOLUTO Y 15cm DE POLIPROPILENO A LOS COSTADOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa Isla estructural de PTR rectangular de 5.10 mts x 0.65 mts x 0.90 mts, (La,An,Al), en forma mixta de "CUADRO" y "C" con tapa de lámina galvanizada cal. 18 para permitir que sean modulares y que se fijen a piso, modulada en 3 partes de 1.7mts c/u, con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida color gris oscuro MC en la estructura, con cubierta de melamina color blanco absoluto de 28 mm de espesor de 5.10 mts, con 15 cm de polipropileno de alta densidad color blanco de uso rudo en cada costado de la mesa, con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable con 2 orificios y bisagra para colocar riel sobre la cubierta. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>
9	<p>La Convocante realiza la siguiente aclaración para la partida 28:</p> <p>Debe decir: BANCO ALTO DE LABORATORIO FIJO CON ASIENTO EN MADERA DE 2 PULGADAS DE ESPESOR DE 14" DE DIÁMETRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA DE 1 (UNA) PULGADA DE ACERO RECUBIERTO CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Bancos de laboratorio fijo reforzado, con asiento fabricado en madera de 2 pulgadas de espesor de 14" de diámetro con descansa pies, estructura tubular redonda de 1 (una) pulgada de acero recubierto con pintura epóxica electrostática color negro con placa cuadrada de 0.20mts X 0.20 mts cal. 16, con regatones de goma para evitar rayaduras y desgaste. Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y/O MATERIALES</p>
10	<p>La Convocante realiza la siguiente aclaración para la partida 31 (se elimina válvula de gas y torreta eléctrica):</p> <p>Se solicita que la partida se oferte conforme a las siguientes características:</p> <p>MESA DE DEMOSTRACION DE 2.05mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28mm, CON UN CONTACTO ELÉCTRICO DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho,</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

	<p>cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; con 1 contacto eléctrico de acero inoxidable de 110v y tapa abatible contra agua.</p> <p><u>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</u></p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>
11	<p>La Convocante realiza la siguiente aclaración conforme a lo solicitado en el Anexo "1" y lo siguiente:</p> <p>Además de considerar todo lo establecido en el numeral "X.8.1 Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro.</p>

El Presidente, dio inicio al acto señalando que se recibieron, el escrito de interés en participar de las empresas COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V., R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., BECOMAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V. y DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO, S.A DE C.V., las preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria a través de correo electrónico, de las siguientes personas: -----

No.	Empresa	Forma de presentación	No. de preguntas
1	COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.	Correo electrónico	02
2	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Correo electrónico	16
3	BECOMAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Correo electrónico	38
4	STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.	Correo electrónico	16
5	DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO, S.A DE C.V.	Correo electrónico	04

Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación: -----

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
Forma de presentación: Correo electrónico.
No. de preguntas: 02

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	Numeral IX EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	En la tabla del desglose de conjunto de partidas y entrega de muestra física, donde indica las partidas 2, 18, 4, 20 y 30, la muestra física que se está solicitando sólo es para la partida 2 , sin embargo, en el numeral X. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS , en el punto 7.1 en el segundo párrafo, dice lo siguiente: <i>"Para las partidas 2, 4,</i>

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		<p>18, 20, 28 y 30, se requiere muestra física, una pieza por cada modelo, conforme a los requerimientos solicitadas en el numeral IX." En este sentido ¿se deben presentar ambas muestras o sólo la que se indica en el numeral IX? Ya que en el anexo "12" Formato entrega-recepción, punto 7.1 indica que la muestra física a presentar es conforme al numeral IX</p> <p>Respuesta: Para el conjunto de partidas 3 (partidas 2, 18, 4, 20 y 30) presentar solo la muestra física de la partida 2 de acuerdo a las especificaciones detalladas en la aclaración.</p>
...	Anexo "1" Descripción de los bienes	<p>Partidas 2, 18, 4, 20 y 30, aparte de las certificaciones ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 también solicitan el REPSE, ¿nos puede, por favor explicar el motivo o para qué se utilizaría el REPSE en estas partidas?</p> <p>Respuesta: Para el conjunto de partidas 3 (partidas 2, 18, 4, 20 y 30) es deseable presentar el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y/u Obras Especializadas REPSE, el no presentarlo no es causa de desechamiento.</p>

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:



Empresa: R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 16

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	ANEXO 1 Descripción de los bienes	<p>Se solicita certificaciones ISO 9001:2015, ISO13485:2016, la pregunta es: ¿se tiene que presentar documento vigente de los certificados?</p> <p>Respuesta: Si, los certificados que presenten los licitantes deben estar vigentes.</p>
2	ANEXO 1 Descripción de los bienes	<p>Al no contar con el certificado, ISO13485:2016, el cual hace referencia al diseño y la fabricación de dispositivos médicos y en la presenta licitación no se solicitan, ¿se puede participar en este procedimiento?</p> <p>Respuesta: Para el caso de las partidas en donde se solicita el cumplimiento de la norma ISO 13485:2016, es deseable presentar una oferta donde se acredite el cumplimiento y la presentación del certificado, el no presentarlo no es causa de desechamiento. Sin embargo, se deberán presentar los certificados establecidos en la aclaración hecha por la convocante, así como cumplir con la norma ISO 9001:2015.</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

3	ANEXO Descripción de los bienes	1 En diferentes partidas solicitan el perfil tipo K, ¿se pueden suministrar las mesas con el perfil recto? Respuesta: No se acepta su propuesta. Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria se deberán suministrar patas estructurales de perfil tipo "K" para las partidas 1, 3, 5, 17, 19, 21, 29, 31 y 32.
4	ANEXO Descripción de los bienes	1 En caso de no aceptar la propuesta del perfil recto, nos pueden proporcionar un dibujo detallado con las medidas y ángulos para fabricar el perfil tipo K Respuesta: favor de considerar la imagen de referencia del Anexo "1", se agrega el diagrama del perfil tipo k, como ejemplo, cada licitante deberá presentar su proyecto conforme a sus diseños específicos.  
5	ANEXO Descripción de los bienes	1 Referente al perfil tipo "k" ¿nos pueden decir con que tipo y medida está fabricado? Por ejemplo, perfil cuadrado de 2 x 2 pulgadas calibre 18. Respuesta: considerar lo establecido en la convocatoria, la imagen de referencia y la respuesta de la pregunta anterior.
6	ANEXO Descripción de los bienes	1 En las partidas donde solicitan gabinetes, solicitan que su interior sea totalmente liso sin cremalleras, al eliminar las cremalleras del gabinete se disminuye la capacidad de carga, ya que sirven para darle una mayor capacidad de carga y para fijar los entrepaños y correderas, por ejemplo, un Gabinete puede soportar 400kg de carga, si se eliminan las cremalleras solo soportara 75 kg de carga, la pregunta es ¿se puede ofertar muebles con cremalleras? Respuesta: Se deberá ofertar conforme a las características establecidas en la convocatoria.
7	ANEXO Descripción de los	1 En las partidas donde solicitan cubiertas de acero inoxidable, solicitan almas de acero inoxidable, la pregunta es ¿se puede proponer las almas de lámina galvanizada ya que estas cumplen con el soporte












**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

	bienes		necesario? Respuesta: No se acepta su propuesta. Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria se requiere que esas mesas y barras cuenten con almas de soporte de acero inoxidable, es el refuerzo de la cubierta y garantiza durabilidad sin corrosión.
8	ANEXO Descripción de los bienes	1	En las partidas que solicitan correderas ocultas con sistema de cierre lento y suave, la pregunta es ¿se puede ofertar correderas visibles embaladas de cierre lento y suave importadas? Respuesta: No se acepta su propuesta, se deberá ofertar conforme a las características establecidas en la convocatoria.
9	ANEXO Descripción de los bienes	1	Para la partida 11 Campana de extracción, mencionan que las dimensiones requeridas son: Dimensiones internas: 1.02 mts x 0.67 mts x 0.75 mts Dimensiones externas: 1.20 mts x 0.80 mts x 2.35 mts ¿se pueden ofertar las siguientes dimensiones sin que esto afecte su funcionamiento? Dimensiones internas: 0.96 mts x 0.58 mts x 0.90 mts Dimensiones externas: 1.22 mts x 0.76 mts x 2.30 mts Respuesta: Sí se podrá ofertar con estas dimensiones, siempre y cuando se cumpla con las demás características solicitadas en la convocatoria. En las medidas externas se deberá ofertar respetando una tolerancia de las medidas especificadas en +/- 5 cm.
10	ANEXO Descripción de los bienes	1	Para la partida 11 Campana de extracción, mencionan que la campana cuenta con pantalla LED para ajuste de velocidad, la pregunta es ¿se puede suministrar campana con velocidad de extracción fija?, se entregaría reporte de funcionamiento de la campana, en el entendido que la campana no contaría con pantalla LED. Respuesta: No se acepta la propuesta. Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria se requiere que la campana de extracción cuente con pantalla para ajuste de velocidad.
11	ANEXO Descripción de los bienes ANEXO Descripción de los bienes	1 1	Para la partida 11 Campana de extracción, favor de indicar la potencia del motor para la extracción. Por ejemplo, ¼ hp y materiales del mismo, por ejemplo si debe de ser el caracol y la propela de polipropileno, indicar marca y modelo para cotizar lo que requieren Respuesta: No se especifican marcas y modelos para esta partida, se debe cotizar cualquier marca y modelo que cumpla con las especificaciones descritas. El caracol y la propela deben ser de polipropileno.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

12	ANEXO Descripción de los bienes	1	<p>Para la partida 11 Campana de extracción, favor de indicar cual sería la alimentación eléctrica del motor por ejemplo 127v, 220v bifásico o 220 v trifásico</p> <p>Respuesta: Extractor Centrifugo trifásico de 1/2 hp. 220/440 v. para 1,530 m3/hr; ideal para atmosferas corrosivas.</p>
13	ANEXO Descripción de los bienes	1	<p>Para la partida 11 Campana de extracción, favor de indicar donde quedaría el motor en techo o en muro</p> <p>Respuesta: El motor queda a muro en la parte exterior por el lateral izquierdo</p>
14	ANEXO Descripción de los bienes	1	<p>Para la partida 11 Campana de extracción, favor de indicar a que distancia quedaría el motor con respecto a la campana de extracción de humos.</p> <p>Respuesta: De acuerdo al plano, está a 4mts de distancia</p>
15	ANEXO Descripción de los bienes	1	<p>Para la partida 27 Mesa isla estructural, favor de aclarar a que se refiere con 15 cm de polipropileno a los costados y como estarán sujetos a la cubierta de melamina, en la medida de lo posible proporcionar un dibujo más detallado, ya que en el dibujo proporcionado no se aprecia este detalle.</p> <p>Respuesta: Se coloca imagen de referencia, se deberá cumplir las especificaciones y ofertar mueble con diseño propio.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
16	ANEXO Descripción de los	1	<p>Para la partida 28, banco alto de laboratorio fijo con asiento de madera. La pregunta es: se puede ofertar banco tubular de altura 72cms y diámetro de asiento de 29.5cms en polipropileno color negro. Se acepta?</p>









UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

	bienes	Respuesta: no se acepta, favor de cotizar de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y en esta junta de aclaraciones.
--	--------	---

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: BECOMAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.







Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 38

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	IX, EVALUACION DE PROPUESTAS	<p>La adjudicación se hará por partida y en conjunto, es decir las partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35. Serán adjudicadas a un solo proveedor, es correcto?</p> <p>Respuesta: Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria, la adjudicación para la presente licitación se realizará por conjunto de partidas y por partida individual, correspondiendo a lo siguiente:</p> <p>Conjunto 1 (Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35)</p> <p>Conjunto 2 (Partidas 15, 23, 26, 33 y 34)</p> <p>Conjunto 3 (Partidas 2, 18, 4, 20 y 30)</p> <p>Partidas Individuales: 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25 y 28</p>
2	IX, EVALUACION DE PROPUESTAS	<p>Muestras para laspartidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35. La placa de acero que solicitan, es una lamina al corte? O deberá ser una cubierta de acero con el acabado con el que se entregarían los muebles, ¿en caso de ser adjudicado?</p> <p>Respuesta: La muestra que deben presentar es una cubierta de acero con el acabado con el que se entregarían los muebles en calibre 18 y se requiere presentar el Certificado de la Norma ASTM A240, conforme a la aclaración realizada por la convocante.</p>
3	X. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIONE LAS PROPUESTAS, PUNTO 2.3	<p>En caso de no contar con el padron de proveedores vigente 2025, será suficiente, presentar el acta constitutiva y la ultima modificacion, es correcto?</p> <p>Respuesta: para el caso del punto 2.3, en caso de no estar vigente en el padrón de proveedores, se deberá presentar: "Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa con su última modificación y el poder del representante legal, en copia simple."</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

4	XV. GARANTIAS QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES, INCISO B	<p>Solicitan garantía de 20 años para las partidas, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.</p> <p>El ofrecer 20 años de garantía y cumplirlos, son cosas diferentes. Es importante antes de adjudicar, que empresa puede soportar este tiempo, un ejemplo es que una empresa que vendía muebles con muchos años de experiencia, y colocando su marca, ofrecía 20 años de garantía, ganando varias licitaciones en el periodo de 2015 a 2018, y para el 2021 esta empresa desapareció. Por lo cual les sugiero visitar las instalaciones de los licitantes y en su caso de las fábricas que representan. ¿Lo aceptan?</p> <p>Respuesta: La garantía de 20 años por escrito es por defectos de fabricación y vicios ocultos de todo el mueble y los accesorios que conforman la partida y conjuntos de partidas que lo especifican, excepto lo eléctrico.</p> <p>Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo solicitado en el apartado XV, GARANTÍAS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, al licitante adjudicado, se le solicitará cumplir y presentar "Garantía de cumplimiento y vicios ocultos del contrato," o en su caso garantía de cumplimiento y calidad del contrato." Por lo que la mencionada fianza, deberá estar vigente al menos por 5 años.</p>
5	XV. GARANTIAS QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES, INCISO B	<p>Solicitan garantía de 20 años para las partidas, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.</p> <p>La garantía de 20 años es solo por mobiliario, vicios, oxidación, calidad y/o, montaje, en el caso de los accesorios, como partes eléctricas, llaves de gases, llaves de agua. Será la garantía que proporciona el fabricante. es correcto?</p> <p>Respuesta: La garantía de 20 años por escrito es por defectos de fabricación y vicios ocultos de todo el mueble y los accesorios que conforman la partida y conjuntos de partidas que lo especifican, excepto lo eléctrico.</p>
6	XV. GARANTIAS QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES, INCISO B	<p>Solicitan garantía de 20 años para las partidas 27, 29, 31, 32, y 35, y se solicitan con cubierta de melamina, La garantía de 20 años es solo por mobiliario, vicios, oxidación, calidad y/o, montaje y no por el desgaste propio del material, ya que al ser a base de madera impregnada con resina, esta se desgasta y al paso del tiempo, se mostrara la base de madera. ¿Es correcta mi apreciación?</p> <p>Respuesta: La garantía de 20 años por escrito es por defectos de fabricación y vicios ocultos de todo el mueble y los accesorios que conforman la partida y conjuntos de partidas que lo especifican, excepto lo eléctrico.</p>
7	Anexo 1	<p>En relación a las Norma ISO 13485:2016, solicitada para los muebles de laboratorio y en general para todas las partidas solicitadas, como aplica en sus requerimientos, ya que esta norma solo aplica para</p>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

		<p>equipos y aparatos médicos?</p> <p>¿En su caso, en que procedimiento de su fabricación y como aplica esa norma en el mobiliario?</p> <p>Respuesta: Para el caso de las partidas en donde se solicita el cumplimiento de la norma ISO 13485:2016, es deseable presentar una oferta donde se acredite el cumplimiento y la presentación del certificado, el no presentarlo no es causa de desechamiento. Sin embargo, se deberán presentar los certificados establecidos en la aclaración hecha por la convocante.</p>
8	Anexo 1	<p>En relación a la norma ISO9001:2015, deberá cubrir al menos los procedimientos de diseño de mobiliario de laboratorio, desarrollo para la fabricación de mobiliario de laboratorio, producción de mobiliario de laboratorio, venta de mobiliario de laboratorio, montaje de mobiliario de laboratorio así como en el suministro de accesorios de laboratorio, es correcta mi apreciación?</p> <p>En caso que no, que procedimiento de ISO deberá cubrir el certificado?</p> <p>Respuesta: Se deberá presentar la certificación ISO9001:2015 de su empresa, que cubra por lo menos uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fabricación y/o comercialización y/o distribución de mobiliario médico y de laboratorio en acero inoxidable, acero al carbón, aluminio y madera. b. Fabricación de estructuras industriales; comercialización de insumos (médico, laboratorio, industria) c. Diseño de mobiliario de laboratorio, desarrollo para la fabricación de mobiliario de laboratorio, producción de mobiliario de laboratorio, venta de mobiliario de laboratorio, montaje de mobiliario de laboratorio.
9	Anexo 1	<p>El certificar procedimientos, no garantiza la calidad del producto, es importante el uso de materiales o materias primas de primera calidad, una parte fundamental es la Lámina Galvanizada, esta deberá cumplir con las normas ASTM A-653, ¿verdad?</p> <p>Respuesta: Los licitantes pueden presentar su certificado ASTM A-653, sin embargo, no es obligatorio. La certificación ISO 9001 si se requiere para participar en las partidas que lo señalen, así como las certificaciones solicitadas en las aclaraciones hecha por la convocante.</p>
10	Anexo 1	<p>El acero inoxidable ANSI T-304, deberá cumplir con las normas ASTM-A240 / A 240M-19 STD, y cumplir con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas: ASME SA 240-17 QQ-S 766-D, MIL-S-5059-D. AMS55 13J, es así?</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

		<p>Respuesta: Es suficiente con solo presentar el certificado ASTM A240, y conforme a la aclaración realizada en esta junta de aclaraciones.</p>
11	Anexo 1	<p>¿La pintura en polvo electrostática horneada deberá contar con certificado de cámara salina por 1035 horas?</p> <p>Respuesta: No es necesario presentar certificado.</p>
12	Anexo 1	<p>Los muebles de laboratorio en general se fabrican con lamina calibre 20, los gabinetes, los armarios, alacenas, anaqueles. ¿Se solicitan en calibre 18, podemos ofertarlos en calibre 20?</p> <p>En caso que no se acepte, como se hará la verificación del calibre la lamina al licitante ganador?</p> <p>Respuesta: No se acepta su propuesta. Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria se deberán suministrar en calibre 18. Para verificar el calibre de la lámina se usará los sistemas de pruebas que la convocante, áreas usuarias y requirentes estimen necesarias.</p>
13	Anexo 1	<p>Se podrá presentar un certificado de pruebas mecánicas y químicas realizado a los muebles ofertados?</p> <p>Respuesta: No es necesario presentar el certificado, sin embargo si se podrá presentar como parte de la propuesta de cada licitante.</p>
14	Anexo 1	<p>¿Existe alguna tolerancia en medidas?</p> <p>Respuesta: Al ser un proyecto conforme a las necesidades de cada laboratorio, No es posible tener tolerancia en las medidas. Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria, se deberán respetar las medidas establecidas, a excepción de la tolerancia correspondiente a la partida de la campana de extracción, conforme a la respuesta realizada previamente.</p>
15	Anexo 1, partida 1 y 17	<p>Mesa rectangular estructural, la cubierta de acero inoxidable se modula y entrega seccionada y se arma en sitio. El sistema anti escurrimiento, únicamente aplica en el área de las tarjas, en nuestro caso en las 2 cabeceras se ofertaran cubiertas de 140 x 57 cm, el resto de la cubierta será lisa, el hecho que toda la cubierta tenga un borde anti escurrimiento, como se esta manejando torretas eléctricas, podría propiciar acumulación de agua y un posible corto circuito, es correcto?</p> <p>Respuesta: El borde anti-escurrimiento es solo para las tarjas.</p>
16	Anexo 1, partida 1 y 17	<p>La dimensión de la tarja es de 48 x 40 x 25 cm, frente, fondo, profundo?</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		<p>Respuesta: Debe ser de 50 cm X 40 cm X 30 cm (frente, fondo y profundidad) debe ser amplia para facilitar la manipulación de los utensilios propios del laboratorio.</p>
17	Anexo 1, partida 1 y 17	<p>A que se refieren a la medida de 0.37 x 0.30 x .030 (largo, ancho, profundo)?</p> <p>Respuesta: Son las medidas del contenedor para utensilios de lavado y desechos integrado en la puerta del gabinete porta tarja fabricado con lámina galvanizada cal. 18, medidas de 0.37mts X 0.30mts X 0.30mts (largo, ancho, profundidad).</p>
18	Anexo 1, partida 1 y 17	<p>¿A que se refieren con borde en el piso de acero inoxidable antifugas?</p> <p>Respuesta: En la parte de adentro de los gabinetes llevarán una cuneta que evita que se escurra por los costados del gabinete en caso de fuga o escurrimiento dentro del cespól, esto contiene el agua dentro del gabinete, es un sistema antifugas.</p>
19	Anexo 1, partida 1 y 17	<p>Toda la tornillería la solicitan 100% en acero inoxidable, se recomienda utilizar pijas autotaladrantes de acero galvanizado, que tampoco se oxida, ya que mecánicamente es mas resistente y garantiza la unión entre laminas.</p> <p>Respuesta: Favor de cotizar de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y en esta junta de aclaraciones.</p>
20	Anexo 1, partida 1 y 17	<p>Se entiende que las cubiertas de acero inoxidable las solicitan con alma de soporte de acero inoxidable. A excepción de laboratorios médicos y/o de alimentos, las lamas las hacemos con lamina galvanizada, que no se oxida, en forma de omega y con recubrimiento impermeabilizante, se acepta?</p> <p>Respuesta: No se acepta, favor de cotizar de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y en esta junta de aclaraciones.</p>
21	Anexo 1, partida 1 y 17	<p>Las tapas de la parte debajo de la mesa no pueden se 2.40 m de largo, ya que en las cabeceras estan las tarjas, por lo tanto, cada fabricante pondrá la tapa menos el ancho de la tarja que ofrezca.</p> <p>Respuesta: Las tapas son de la parte central de la mesa isla, no de las tarjas, favor de revisar la descripción de las especificaciones.</p>
22	Anexo 1,	<p>Varias mesas se colocarán en un área provisional.</p> <p>Se entiende que esto implica un montaje, un desmontaje y otro montaje y este costo se deberá cotizar en este procedimiento, al cual le deberemos poner una vigencia por lo menos de lo que resta del</p>


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**







		<p>año. En caso que pase este periodo, se podrán ajustar estos costos?</p> <p>Respuesta: Para las partidas en donde se solicita este servicio, considerar en su propuesta al menos 8 meses desde el momento de la entrega e instalación en aula provisional hasta el momento del desmontaje e instalación el aula definitiva. No se podrán ajustar los costos.</p>
23	Anexo 1, partida 11	<p>Campana de extracción de humos.</p> <p>¿Se deberá incluir sistema de extracción? Respuesta: Si.</p> <p>¿Ducto para la extracción? Respuesta: Si.</p> <p>La velocidad del flujo de aire, deberá ajustarse a 100 FPM, ¿conforme de abra o cierre la guillotina? Respuesta: Revisar las especificaciones descritas en la partida mencionada.</p> <p>¿El extractor deberá ser integrado a la campana de extracción? Respuesta: Si.</p> <p>A las campanas de extracción no es recomendable colocarles ruedas, ya que generalmente son fijas, por el sistema de extracción y el drenaje. ¿Se pueden omitir en nuestra oferta? Respuesta: Las ruedas son opcionales.</p>
24	Anexo 1, partida 11	<p>¿Ducto para la extracción? Respuesta: En la pregunta anterior, se da la respuesta a esta pregunta.</p>
25	Anexo 1, partida 11	<p>La velocidad del flujo de aire, deberá ajustarse a 100 FPM, ¿conforme de abra o cierre la guillotina? Respuesta: En la pregunta 23, se da la respuesta.</p>
26	Anexo 1, partida 11	<p>¿El extractor deberá ser integrado a la campana de extracción? Respuesta: En la pregunta 23, se da la respuesta.</p>
27	Anexo 1, partida 11	<p>A las campanas de extracción no es recomendable colocarles ruedas, ya que generalmente son fijas, por el sistema de extracción y el drenaje. ¿Se pueden omitir en nuestra oferta? Respuesta: En la pregunta 23, se da la respuesta.</p>
28	Anexo 1, partida 6, 7,	<p>En estas partidas, solicitan gabinetes con puertas deslizables y</p>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.


	8, 10,	<p>entrepaño ajustable, solicitan que el gabinete sea totalmente liso, sin cremalleras, entrepaño ajustable. ¿Si no tiene cremalleras, de qué forma se ajusta el entrepaño?</p> <p>Respuesta: Por higiene y limpieza, deberá ser un sistema de nivelación sin cremalleras.</p>
29	Anexo 1, partida 6, 7, 8, 10,	<p>Se pueden ofertar puertas abatibles, ya que con una puerta abatible, se puede tener un mejor acceso tanto para guardar como para ver el 100% de lo que esta guardado. Con una puerta deslizable, se pierde el 50% de visión así como la posibilidad de guardar algo que quepa en el gabinete, pero por no poder abrir el 100% de la puerta. Se acepta?</p> <p>Respuesta: No se acepta su propuesta. Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria, se deberán suministrar con las características especificadas.</p>
30	Anexo 1	<p>Mobiliario para laboratorio de física.</p> <p>En general en sus mesas solicitan cubiertas de melamina, que es un material económico, útil, decorativo, sin embargo, el uso rudo de una institución educativa, no es muy durable, bajo las mismas características, sugerimos el plástico laminado, el cual podría soportar un poco más, pero no deja de ser material a base de madera.</p> <p>Acarando que la garantía, será sobre vicios ocultos, oxidación, montaje, no así sobre el desgaste propio del mueble, en este caso de las cubiertas.</p> <p>por lo anterior, y en el entendido que requieren de un material no metálico para este laboratorio, les sugerimos cubiertas de resina fenólica, la cual tendrá una vida mucho mas larga que la melamina más resistente, antiestática y que soporta calor y humedad.</p> <p>Se acepta?</p> <p>Respuesta: No se acepta su propuesta. Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria, se deberán suministrar con las características especificadas.</p>
31	Anexo 1 partida 27	<p>Mesa isla estructural rectangular de 5.10 x 0.65 x 0.90, podrían proporcionar un diseño o boceto de la forma en que requieren esta mesa?</p> <p>Respuesta: Se coloca imagen de referencia, se deberá cumplir las especificaciones y ofertar mueble con diseño propio.</p>










**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		
32	Anexo 1 partida 27	<p>Se entiende que son 3 mesas modulares, las cuales se podrían mover, según sus necesidades. Por que las requieren ancladas al piso?</p> <p>Respuesta: Debido a que instalarán en aula provisional, se requiere que sean modulares y sin fijación al piso, posteriormente, al instalarlas en el laboratorio definitivo, deben quedar fijas a piso.</p>
33	Anexo 1 partida 27	<p>Como se coloca o a que se refieren cuando describen 15 cm de poliuretano de color blanco de uso rudo en cada costado de la mesa.</p> <p>Este poliuretano, se colocara en cada modulo de 1.7m o en los extremos de la mesa completa de 5.1 m?</p> <p>Respuesta: Deberá ser polipropileno y estará "volado" de los 15cm en una sola base y se colocará únicamente a los costados sobre la melamina de 28mm, será para colocar las prensas y evitar que se marquen éstas en la melamina por la fuerza de presión.</p>
34	Anexo 1 partida 27	<p>Las torretas eléctricas, es una por modulo o, 3 por modulo de 1.7 m=</p> <p>Respuesta: Es una torreta por módulo, es decir, serán 3 torretas por mesa, colocadas en la parte posterior debajo de la melamina.</p>
35	Anexo 1, partida 23 y 33	<p>Rack para almacenaje de microscopios de 0.90 x 0.45 x 2.20 m</p> <p>Favor de ampliar la especificación o en defecto, podemos ofertar un anaquel con entrepaños ajustables con postes en escuadra calibre 14 y entrepaños reforzados calibre 20 (4 pzas) para tener 3 espacios de poco mas de 60 cm.</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		<p>Se acepta?</p> <p>Respuesta: No se acepta, apegarse a las especificaciones de la aclaración que realiza la convocante en esta junta.</p>
36	Anexo 1 partida 25	<p>Armario con puerta de acrílico transparente.</p> <p>¿Se podrá ofertar con puertas abatibles con marco metálico y vidrio transparente? Ya que el acrílico se raya y opaca en corto tiempo. Se acepta?</p> <p>Respuesta: No se acepta su propuesta. Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria, se deberán suministrar con las características especificadas.</p>
37	Anexo 1 partida 26	<p>Rack para mochilas, de 0.90 x 0.60 x 2.20 m,</p> <p>Si el rack mide 0.90 x 0.60, como se colocan los entrepaños de 0.30 x 030?</p> <p>Se puede ampliar la descripción y de ser posible mostrar una imagen, ya que la imagen de las bases, corresponde a un anaquel abierto.</p> <p>Respuesta: Se coloca imagen de referencia, se deberá cumplir las especificaciones establecidas en la convocatoria.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
38	Anexo 1 partida 34	<p>Rack de guardado mixto, siendo un mueble metálico, donde va la cubierta de melamina?</p> <p>Respuesta: La cubierta de melamina estará en la parte superior</p>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

		de los cajones.
--	--	-----------------

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.
 Forma de presentación: Correo electrónico.
 No. de preguntas: 16

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	2	<p>¿Es banco fijo (4 patas fijas, con regaton) o es de 5 patas con rodajas?</p> <p>Respuesta: Es un banco de 5 patas, con altura ajustable y regatone, puede girar 360°, sin ruedas. Considerar la imagen de referencia colocada para la aclaración de la partida 2, realizada en esta junta de aclaraciones.</p>
2	2	<p>¿El aro descansa pies es de altura fija, o es de altura ajustable?</p> <p>Respuesta: De altura ajustable. Considerar la imagen de referencia colocada para la aclaración de la partida 2.</p>
3	2	<p>¿En caso de que el aro descansa pies sea de altura fija, que altura debe de tener respecto al piso?</p> <p>Respuesta: Es de altura ajustable. Considerar la imagen de referencia colocada para la aclaración de la partida 2.</p>
4	4	<p>¿El aro descansa pies lo requieren en acero cromado ó puede ofrecerse en poliamida ?</p> <p>Respuesta: El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado, cumpliendo además con las demás características.</p>
5	4	<p>¿El aro descansa pies es de altura fija, o es de altura ajustable?</p> <p>Respuesta: Es de altura ajustable. Considerar la imagen de referencia colocada para la aclaración de la partida 2.</p>
6	4	<p>¿En caso de que el aro descansa pies sea de altura fija, que altura debe de tener respecto al piso?</p> <p>Respuesta: Conforme a la respuesta anterior, no aplica la pregunta.</p>
7	18	<p>¿Es banco fijo (4 patas fijas, con regaton) o es de 5 patas con rodajas?</p> <p>Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante, se le da respuesta a su pregunta.</p>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

8	18	<p>¿El aro descansa pies es de altura fija, o es de altura ajustable?</p> <p>Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante, se le da respuesta a su pregunta.</p>
9	18	<p>¿En caso de que el aro descansa pies sea de altura fija, que altura debe de tener respecto al piso?</p> <p>Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante, se le da respuesta a su pregunta.</p>
10	20	<p>¿El aro descansa pies lo requieren en acero cromado ó puede ofrecerse en poliamida ?</p> <p>Respuesta: El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado, cumpliendo además con las demás características.</p>
11	20	<p>¿El aro descansa pies es de altura fija, o es de altura ajustable?</p> <p>Respuesta: Es de altura ajustable.</p>
12	20	<p>¿En caso de que el aro descansa pies sea de altura fija, que altura debe de tener respecto al piso?</p> <p>Respuesta: Conforme a la respuesta anterior, no aplica.</p>
13	28	<p>¿Se puede ofrecer asiento de POLIPROPILENO de alta densidad en vez de madera?</p> <p>Respuesta: No se acepta, cotizar conforme lo establecido en las bases de la convocatoria.</p>
14	30	<p>¿El aro descansa pies lo requieren en acero cromado ó puede ofrecerse en poliamida ?</p> <p>Respuesta: El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado, cumpliendo además con las demás características.</p>
15	30	<p>¿El aro descansa pies es de altura fija, o es de altura ajustable?</p> <p>Respuesta: Es de altura ajustable.</p>
16	30	<p>¿En caso de que el aro descansa pies sea de altura fija, que altura debe de tener respecto al piso?</p> <p>Respuesta: Conforme a la respuesta anterior, no aplica.</p>

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

Forma de presentación: Correo electrónico.
No. de preguntas: 04

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35	Las muestras deberán ser un trozo el meta de 30 x30 cms (material) con que se fabricaran los muebles o podemos entregar una muestra física a escala? Respuesta: Sí se podrá presentar muestra física a escala (1 pieza, no es obligatorio), además deberá incluir las pieza de acero y melamina conforme a lo solicitado en esta junta de aclaraciones.
2	27,29,31,34,35,	En estas partidas nos solicitan cubiertas de melanina, les sugerimos un material más resistente, como una resina fenólica, la cual presenta propiedades de ser anti-estática y es más resistente a la humedad, con lo cual se puede garantizar 20 años que es la garantía que ustedes solicitan, la resina fenólica es un producto con mayor resistencia muy resistente a la humedad y calor con la que se puede trabajar en las mismas, acepta el cambio? Respuesta: No se acepta su propuesta. Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria, se deberán suministrar con las características especificadas.
3	11	La campana de extracción, están ancladas un drenaje, y un ducto, por lo cual , deberá llevar llantas ya que no es movible Respuesta: Las ruedas son opcionales.
4	Anexo 1: 1 y 17	Las cubiertas de acero inoxidable, las solicitan con alma de acero o de madera que es un producto que contamina y no es duradero, las que fabricamos son de acero galvanizado , lo acepta así? Respuesta: No se acepta su propuesta. Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria se requiere que esas mesas y barras cuenten con almas de soporte de acero inoxidable, es el refuerzo de la cubierta y garantiza durabilidad sin corrosión.


Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día **28 de abril de 2025, a las 11:00 horas**, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas.


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:-----

C. Beatriz E. Rivera de Loera
**Jefa del Departamento de Compras y Secretario
Técnico del Comité de Compras**



C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón
Representante de la Contraloría Universitaria



C. María Díaz Rodríguez
Representante del Departamento Jurídico



C. Ana Francisca Contreras Mejía
**Representante de la Dirección General de Planeación
y Desarrollo**




C. David Carrillo López
**Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales
(área requirente)**



C. José de Jesús Martín Núñez
Departamento de Construcciones de la DGIU



C. Lisly Paola Jiménez de Alba
Departamento de Compras



C. Arnoldo Rodríguez Romo
Departamento de Compras



C. Berenice Ceballos Guzmán
Departamento de Compras



C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera
Departamento de Compras



Por parte de los Licitantes: -----

C. Adrián Flores González
COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS,
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

C. Héctor Cornejo Sosa
METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.





C. Alejandro Herrera Rodríguez
STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.

Siendo las **10:50** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.

FIN DE TEXTO



